

## Instruções de uso

# RealStar<sup>®</sup> RSV RT-PCR Kit 3.0

01/2017 PT

# RealStar®

## RSV RT-PCR Kit 3.0

Para utilização com

Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)  
VERSANT® kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)  
ABI Prism® 7500 SDS (Applied Biosystems)  
ABI Prism® 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)  
Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research)  
Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)  
CFX96™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)  
CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)  
LightCycler® 480 Instrument II (Roche)



193013



96



01 2017



altona Diagnostics GmbH • Mörkenstr. 12 • D-22767 Hamburg

## Conteúdo

<b>1. Utilização Prevista .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Componentes do Kit .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Armazenamento .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Materiais e Dispositivos requeridos mas não fornecidos.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Informação de Base .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Descrição do Produto.....</b>	<b>9</b>
6.1 Instrumento de PCR em tempo real.....	10
<b>7. Avisos e Precauções .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Procedimento .....</b>	<b>12</b>
8.1 Preparação de Amostras.....	12
8.2 Preparação da Master Mix.....	13
8.3 Preparação da Reação .....	15
<b>9. Programação dos instrumentos de PCR em tempo real.....</b>	<b>16</b>
9.1 Definições .....	16
9.2 Detetores de fluorescência (corantes) .....	16
9.3 Perfil de Temperatura e Aquisição de Corante.....	17
<b>10. Análise de Dados .....</b>	<b>18</b>
10.1 Validade dos Processamentos do Teste de Diagnóstico.....	18
10.1.1 Processamento de Teste de Diagnóstico Válido.....	18
10.1.2 Processamento de Teste de Diagnóstico Inválido .....	19
10.2 Interpretação dos Resultados .....	19
10.2.1 Análise Qualitativa .....	19

<b>11. Avaliação do Desempenho.....</b>	<b>20</b>
11.1 Sensibilidade Analítica .....	21
11.2 Especificidade Analítica .....	23
11.3 Precisão .....	24
<b>12. Limitações .....</b>	<b>25</b>
<b>13. Controlo de Qualidade.....</b>	<b>26</b>
<b>14. Apoio Técnico .....</b>	<b>26</b>
<b>15. Bibliografia .....</b>	<b>26</b>
<b>16. Marcas Comerciais e Isenções de Responsabilidade .....</b>	<b>27</b>
<b>17. Explicação de Símbolos .....</b>	<b>28</b>

## 1. Utilização Prevista

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é um teste de diagnóstico *in vitro* baseado na tecnologia de PCR em tempo real para a detecção qualitativa do ARN específico do vírus sincicial respiratório (VRS). Além disso, o teste permite a diferenciação entre o ARN específico do vírus sincicial respiratório do subtipo A (VSR A) e o vírus sincicial respiratório do subtipo B (VSR B).

## 2. Componentes do Kit

Cor cobertura	Componente	Número de frascos	Volume [µl/tubo]
Azul	Master A	8	60
Violeta	Master B	8	180
Verde	Internal Control	1	1000
Vermelho	Positive Control RSV A	1	250
Laranja	Positive Control RSV B	1	250
Branco	Water (PCR grade)	1	500

Internal Control (IC) = Controle interno

Positive Control (PC) = Controle positivo

Water (PCR grade) = Água de PCR

## 3. Armazenamento

- O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é enviado em gelo seco. Os componentes do kit devem chegar congelados. Se um ou mais componentes não estiverem congelados no momento da recepção, ou se algum tubo tiver ficado comprometido durante o envio, contacte a Altona Diagnostics GmbH para obter assistência.
- Todos os componentes devem ser conservados entre -25 °C e 15 °C depois do momento da entrega.
- Deve-se evitar o congelamento e descongelamento repetido de reagentes Master (mais do que duas vezes), pois isto poderá afetar o desempenho do

ensaio. Os reagentes devem ser congelados em alíquotas se a sua utilização prevista for intermitente.

- O armazenamento entre +2 °C e +8 °C não deve exceder um período de duas horas.
- Proteger o Master A e o Master B da luz.

## 4. Materiais e Dispositivos requeridos mas não fornecidos

- Instrumento de PCR em tempo real adequado (consulte o capítulo 6.1. Instrumentos de PCR em tempo real)
- Sistema ou kit de extração de ácido nucleico adequado
- Centrífuga de bancada com um rotor para tubos de reação de 2 ml
- Centrífuga com um rotor para placas de microtitulação, aquando da utilização de placas de reação com 96 poços
- Agitador vortex
- Placas de reação com 96 poços ou tubos de reação adequados com material de fecho (óticos) correspondente
- Pipetas (ajustáveis)
- Pontas de pipeta com filtros (descartáveis)
- Luvas sem pó (descartáveis)

### NOTA



***Certifique-se de que todos os instrumentos utilizados foram instalados, calibrados, verificados e mantidos de acordo com as instruções e recomendações do fabricante.***



***É altamente recomendada a utilização do rotor de 72 poços com tubos de reação de 0,1 ml adequados, se utilizando o Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research) ou o Rotor-Gene® Q 5/6 plex (QIAGEN).***

## 5. Informação de Base

Os *vírus sincial respiratório humano* (VSR) são vírus ARN de cadeia simples e sentido negativo da família *Paramyxoviridae*. Os VSR são subdivididos em dois grupos genéticos principais, VSR A e VSR B. Numa epidemia, genótipos diferentes de ambos os subgrupos podem co-circular numa frequência variável.

O VSR pode causar infeções do trato respiratório. Praticamente todas as crianças terão sido infetadas com VSR entre os 2 e 3 anos de idade. As novas infeções repetidas podem ocorrer ao longo da vida. Na maioria dos casos, uma infeção por VSR causa apenas sintomas ligeiros, como os de uma constipação comum. Mas em lactentes e em crianças pequenas, o VSR é a causa mais importante da doença respiratória grave e a maior causa de pneumonia e bronquite infantil. Para além disso, o VSR é um problema significativo nos idosos, em pessoas com doenças cardiovasculares e em indivíduos imunocomprometidos.

O VSR é transmitido através de partículas infecciosas ou pelo contacto com as secreções nasais ou orais de pessoas infetadas. São comunicados surtos de infeções por VSR a nível mundial, com uma incidência anual de epidemias durante o inverno e no princípio da primavera em climas temperados, como na Europa e América do Norte e na estação das chuvas nos trópicos.

### NOTA



***Devido à formação molecular relativamente rápida e aos vírus ARN, existe um risco inerente relativamente a qualquer sistema de teste baseado em RT-PCR de a acumulação de mutações ao longo do tempo poder resultar em resultados falsos negativos.***

## 6. Descrição do Produto

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é um teste de diagnóstico *in vitro* baseado na tecnologia de PCR em tempo real para a deteção e diferenciação do vírus sincial respiratório do subtipo A (VSR A) e o ARN específico do vírus sincial respiratório do subtipo B (VSR B). O ensaio inclui um sistema de amplificação heteróloga (Controlo Interno) para identificar possíveis inibições da RT-PCR e para confirmar a integridade dos reagentes do kit.

A tecnologia de RT-PCR em tempo real utiliza uma reação da transcriptase reversa (RT) para converter ARN em ADN complementar (ADNc), reação em cadeia da polimerase (PCR) para a amplificação de sequências alvo específicas e de sondas alvo específicas para a deteção de ADN amplificado. As sondas estão marcadas com repórter fluorescente e corante quencher.

As sondas específicas para VSR A ARN estão marcadas com o fluoróforo Cy<sup>®</sup>5, ao passo que as sondas específicas para VSR B ARN estão marcadas com o fluoróforo FAM<sup>™</sup>. A sonda específica para o Controlo Interno está marcada com o fluoróforo JOE<sup>™</sup>.

A utilização de sondas associada a colorações distinguíveis permite a deteção paralela do VSR A e ARN específico do VSR B, assim como do Controlo Interno nos canais de deteção correspondentes do instrumento de PCR em tempo real.

O teste consiste em três processos num único tubo de ensaio:

- Transcriptase reversa do ARN para ADNc alvo e do Controlo interno
- Amplificação de PCR do ADNc alvo e do Controlo Interno
- Deteção simultânea de amplificações de PCR por sondas marcadas com corante fluorescente

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 consiste em:

- Dois reagentes Master (Master A e Master B)
- Controlo Interno
- Dois Controlos Positivos:
  - Controlo Positivo VSR A
  - Controlo Positivo VSR B
- Água de grau PCR

Os reagentes Master A e Master B contêm todos os componentes (tampão de PCR, transcriptase reversa, ADN polimerase, primers e sondas) necessários para permitir a transcríptase reversa, a amplificação mediada por PCR e a deteção de alvos do ARN específico do VSR A e VSR B, assim como do Controlo Interno numa preparação de reação.

### 6.1 Instrumento de PCR em tempo real

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 foi desenvolvido e validado para utilização com os seguintes instrumentos de PCR em tempo real:

- Mx 3005P™ QPCR System (Stratagene)
- VERSANT® kPCR Molecular System AD (Siemens Healthcare)
- ABI Prism® 7500 SDS (Applied Biosystems)
- ABI Prism® 7500 Fast SDS (Applied Biosystems)
- Rotor-Gene® 6000 (Corbett Research)
- Rotor-Gene® Q5/6 plex Platform (QIAGEN)
- CFX96™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- CFX96™ Deep Well Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- LightCycler® 480 Instrument II (Roche)

## 7. Avisos e Precauções

Leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de utilizar o produto.

- Antes da primeira utilização, verifique o produto e os seus componentes relativamente a:
  - Integridade
  - Totalidade no que diz respeito ao número, tipo e conteúdos (consulte o capítulo 2. Componentes do Kit)
  - Rotulagem correta
  - Congelado aquando o momento da entrega
- A utilização deste produto está limitada a pessoal especialmente instruído e formado em técnicas de PCR em tempo real e procedimentos de diagnósticos *in vitro*.
- Os espécimes devem ser sempre tratados como sendo infecciosos e/ou nocivo, segundo os procedimentos laboratoriais de segurança.
- Utilize luvas protetoras descartáveis sem pó, uma bata de laboratório e proteção ocular quando manusear as amostras.
- Evite contaminação microbiana e por nuclease (DNase/RNase) dos espécimes e dos componentes do kit.
- Utilize sempre pontas de pipeta descartáveis sem DNase/RNase, com barreiras de aerossóis.
- Use sempre luvas protetoras descartáveis sem pó quando manusear os componentes do kit.
- Utilize áreas de trabalho separadas e isoladas para (i) a preparação da amostra, (ii) a preparação da reação e (iii) as atividades de amplificação/deteção. A ordem das tarefas no laboratório deve ser unidirecional. Utilize sempre luvas descartáveis em cada área e troque-as antes de entrar numa área diferente.
- Selecione materiais e equipamentos específicos para cada área de trabalho individual e não os transfira de uma área para outra.

- Guarde o material positivo e/ou potencialmente positivo separado de todos os outros componentes do kit.
- Não abra os tubos/placas de reação pós-amplificação para evitar a contaminação com amplicões.
- Os controlos adicionais poderão ser testados segundo as diretrizes ou requisitos de regulamentações estatais e/ou federais ou organizações acreditadas.
- Não utilize a autoclave para os tubos de reação após a PCR, dado que não iria degradar o ácido nucleico amplificado e iria suportar o risco de contaminar a área de laboratório.
- Não utilize componentes do kit que tenham passado do prazo de validade.
- Deite fora os resíduos de amostras e ensaios respeitando as regulamentações de segurança locais.

## 8. Procedimento

### 8.1 Preparação de Amostras

O ARN extraído é o material inicial para o RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0.

A qualidade do ARN extraído tem um impacto profundo no desempenho de todo o sistema de teste. É necessário assegurar que o sistema utilizado para a extração de ácido nucleico é compatível com a tecnologia de PCR em tempo real. Os seguintes kits e sistemas são adequados para a extração de ácido nucleico:

- QIAamp® Viral RNA Mini Kit (QIAGEN)
- QIASymphony® (QIAGEN)
- NucliSENS® easyMag® (bioMérieux)
- MagNA Pure 96 System (Roche)
- m2000sp (Abbott)
- Maxwell® 16 IVD Instrument (Promega)
- VERSANT® kPCR Molecular System SP (Siemens Healthcare)

Os seguintes kits e sistemas de extração de ácido nucleico também podem ser adequados. A adequação do procedimento de extração de ácido nucleico para utilização com RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 deve ser validada pelo utilizador.

No caso da utilização de um procedimento de preparação de amostras baseado numa coluna de centrifugação, incluindo tampões de lavagem contendo etanol, recomenda-se vivamente um passo de centrifugação adicional de 10 min. a aproximadamente 17 000 x g (~ 13 000 rpm), utilizando um tubo de colheita novo, antes da eluição do ácido nucleico.

#### ATENÇÃO



***Se o seu sistema de preparação de amostras utilizar tampões de lavagem contendo etanol, certifique-se de que elimina quaisquer vestígios de etanol antes da eluição do ácido nucleico. O Etanol é um forte inibidor de PCR em tempo real.***



***A utilização de ARN transportador é crucial para a eficiência da extração e estabilidade do ácido nucleico.***

Para obter informações adicionais e assistência técnica relativamente ao pré-tratamento e preparação de amostras, contacte o nosso Apoio Técnico (consulte o capítulo 14. Apoio Técnico).

### 8.2 Preparação da Master Mix

Todos os reagentes e amostras devem ser completamente descongelados, misturados (através de pipetagem ou por agitação ligeira em vortex) e centrifugados brevemente antes da utilização.

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 contém um Controlo Interno heterólogo, que pode ser utilizado como um controlo de inibição de RT-PCR ou para controlar o procedimento de preparação de amostras (extração de ácido nucleico) e como um controlo de inibição de RT-PCR.

- ▶ Se o Controlo Interno for utilizado como um controlo de inibição de RT-PCR, mas não como um controlo para o procedimento de preparação de amostras, o Master Mix é configurado segundo o seguinte esquema de pipetagem:

Número de Reações (reações)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	15 µl	180 µl
Controlo Interno (Internal Control)	1 µl	12 µl
<b>Volume da Master Mix</b>	<b>21 µl</b>	<b>252 µl</b>

- ▶ Se o Controlo Interno for utilizado para o procedimento de preparação de amostras e como um controlo de inibição de RT-PCR, adicione o Controlo Interno durante o procedimento de extração de ácido nucleico.
- ▶ Independentemente do método/sistema utilizado para a extração de ácido nucleico, o Controlo Interno **não deve** ser adicionado diretamente à amostra. O Controlo Interno deve ser sempre acrescentado à mistura de tampão de amostra/lise. O volume do Controlo Interno que deve ser adicionado depende sempre e apenas do volume da eluição. Este representa 10% do volume da eluição. Por exemplo, se o ácido nucleico vai ser eluído em 60 µl de tampão de eluição ou água, deve ser adicionado 6 µl de Controlo Interno por amostra à mistura de tampão de espécime/lise.
- ▶ Se o Controlo Interno for acrescentado durante o procedimento de preparação de amostras, o Master Mix é configurado segundo o seguinte esquema de pipetagem:

Número de Reações (reações)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	15 µl	180 µl
<b>Volume da Master Mix</b>	<b>20 µl</b>	<b>240 µl</b>

**ATENÇÃO**

*Se o Controlo Interno foi adicionado durante o procedimento de preparação da amostra, pelo menos o controlo negativo deve incluir o Controlo Interno*



*Independentemente do método/sistema utilizado para a extração de ácido nucleico, nunca adicione Controlo Interno diretamente ao espécime.*

**8.3 Preparação da Reação**

- ▶ Pipete 20 µl da Master Mix para cada poço necessário de uma placa de reação ótica com 96 poços adequada ou um tubo de reação ótico adequado.
- ▶ Adicione 10 µl da amostra (eluato da extração de ácido nucleico) ou 10 µl do controlo (controlo positivo ou negativo).

Preparação da Reação	
Master Mix	20 µl
Controlo da Amostra	10 µl
<b>Volume Total</b>	<b>30 µl</b>

- ▶ Certifique-se de que são utilizados todos os controlos positivos e pelo menos um controlo negativo por processamento.
- ▶ Misture cuidadosamente as amostras e os controlos com a Master Mix através de pipetagem para cima e para baixo.
- ▶ Feche a placa de reação com 96 poços com as tampas adequadas ou uma película adesiva ótica e os tubos de reação adequados.
- ▶ Centrifugue a placa de reação com 96 poços numa centrífuga com rotor para placas de microtitulação durante 30 segundos a aproximadamente 1000 x g (~ 3000 rpm).



## 9. Programação dos instrumentos de PCR em tempo real

Para obter informações relativas à configuração e programação dos diferentes instrumentos de PCR em tempo real, consulte o manual do utilizador do respetivo instrumento.

Para obter instruções detalhadas relativamente à utilização do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 em instrumentos de PCR em tempo real específicos, contacte o nosso Apoio Técnico (consulte o capítulo 14. Apoio Técnico).

### 9.1 Definições

- Configure as seguintes definições:

Definições	
Volume de Reação	30 µl
Taxa de rampa	Predefinição
Referência Passiva	ROX™

### 9.2 Detetores de fluorescência (corantes)

- Defina os detetores de fluorescência (corantes):

Alvo	Nome do Detetor	Reporter	Quencher
ARN específico do VSR A	VSR A	Cy <sup>®</sup> 5	(Nenhum)
ARN específico do VSR B	VSR B	FAM™	(Nenhum)
Controlo Interno (Internal Control)	Controlo Interno	JOE™	(Nenhum)

## 9.3 Perfil de Temperatura e Aquisição de Corante

- Defina o perfil de temperatura e a aquisição de corante:

	Fase	Ciclo Repetições	Aquisição	Temperatura [°C]	Tempo [min: seg]
Transcriptase Reversa	Suspensão	1	-	55	20:00
Desnaturação	Suspensão	1	-	95	02:00
Amplificação	Realização de Ciclo	45	-	95	00:15
			sim	55	00:45
			-	72	00:15

## 10. Análise de Dados

Para obter informações básicas relativas à análise de dados em instrumentos de PCR em tempo real, consulte o manual do utilizador do respetivo instrumento.

Para obter instruções detalhadas relativamente à análise dos dados gerados com o RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 em diferentes instrumentos de PCR em tempo real, contacte o nosso Apoio Técnico (consulte o capítulo 14. Apoio Técnico).

### 10.1 Validade dos Processamentos do Teste de Diagnóstico

#### 10.1.1 Processamento de Teste de Diagnóstico Válido

Para que um processamento de teste de diagnóstico seja **válido**, devem existir as seguintes condições de controlo:

ID do Controlo	Canal de Detecção		
	Cy <sup>®</sup> 5	FAM™	JOE™
Controlo Positivo VSR A	+	-	+/-*
Controlo Positivo VSR B	-	+	+/-*
Controlo Negativo	-	-	+

\* A presença ou ausência de um sinal no canal JOE™ não é relevante para a validade do teste.

#### 10.1.2 Processamento de Teste de Diagnóstico Inválido

Um processamento de teste de diagnóstico é **inválido**, (i) se o processamento não tiver sido concluído ou (ii) se alguma das condições de controlo para um processamento de teste de diagnóstico **válido** não estiver presente.

No caso de um processamento de teste de diagnóstico **inválido** repita o teste utilizando os restantes ácidos nucleicos purificados ou comece a partir das amostras originais novamente.

### 10.2 Interpretação dos Resultados

#### 10.2.1 Análise Qualitativa

Canal de Detecção			Interpretação de Resultados
Cy <sup>®</sup> 5	FAM™	JOE™	
+	-	+*	Foi detetado o ARN específico do VSR A.
-	+	+*	Foi detetado o ARN específico do VSR B.
-	-	+	Não foi detetado o ARN específico do VSR A nem do VSR B. A amostra não contém quantidades detetáveis do ARN específico do VSR A ou VSR B.
-	-	-	RT-PCR inibição ou falha ao nível do reagente. Repetir teste a partir da amostra original ou recolher e testar uma nova amostra.

\* Não é necessária a deteção do Controlo interno (Internal control) no canal de deteção JOE™ para resultados positivos no canal de deteção Cy<sup>®</sup>5 ou no canal de deteção FAM™. Carga(s) elevada(s) do ARN do VSR A e/ou VSR B na amostra pode causar a redução ou ausência de sinais de Controlo interno (Internal control).

## 11. Avaliação do Desempenho

A avaliação do desempenho do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 foi efetuada utilizando ARN quantificado do VSR A (ATCC® VR-26D™) e ARN do VSR B (ATCC® VR-955D™).

Em termos de cepas de referência e a maioria dos isolados de VRS testados até agora, o RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 distingue claramente entre VSR A e VSR B de ARN específico. Dependendo dos isolados de VRS e do instrumento de PCR em tempo real utilizado para a análise, pode ocorrer uma leve reatividade cruzada entre o sistema VSR A e VSR B (consulte a Figura 1).

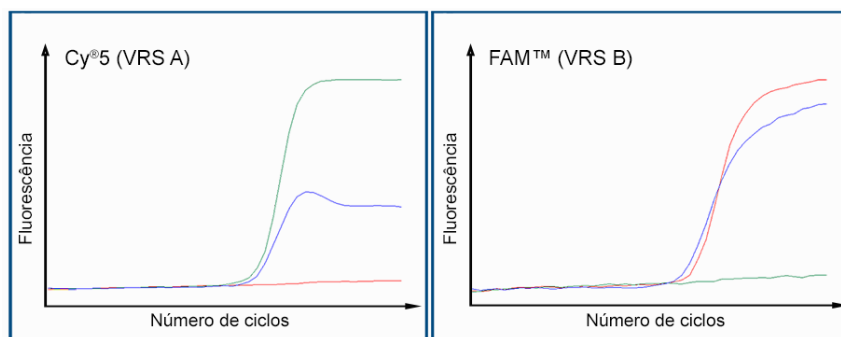


Figura 1: Curvas de amplificação obtidas com o RealStar®RSV RT-PCR Kit 3.0 e extraiu ARN de amostras respiratórias coletadas na Alemanha. Verde: ARN específico de VSR A, apenas detectado no canal Cy5; Vermelho: ARN específico de VSR B, detectado apenas no canal FAM™; Azul: ARN específico de VSR B, amplificação eficiente com o sistema específico VSR B (FAM™) e amplificação / reação cruzada ineficiente com o sistema específico VSR A (Cy5).

### 11.1 Sensibilidade Analítica

A sensibilidade analítica do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 define-se como a concentração (cópias por µl de eluato) de moléculas de ARN específico do VSR A ou VSR B que pode ser detetada com uma taxa de positividade de 95%. A sensibilidade analítica foi determinada através da análise de diluições seriadas do ARN específico do VSR A e VSR B em concentrações conhecidas.

Tabela 1: Resultados da RT-PCR utilizados para o cálculo da sensibilidade analítica no que respeita à deteção de ARN específico do VSR A

Concentração inserida [cópias/µl]	Número de Réplicas	Número de Positivos	Taxa de Positividade [%]
31,622	24	24	100
10,000	24	24	100
3,162	24	24	100
1,000	24	23	96
0,316	24	15	63
0,100	24	5	21
0,032	24	0	0
0,010	24	0	0

Tabela 2: Resultados da RT-PCR utilizados para o cálculo da sensibilidade analítica no que respeita à deteção de ARN específico do VSR B

Concentração inserida [cópias/μl]	Número de Réplicas	Número de Positivos	Taxa de Positividade [%]
31,622	24	24	100
10,000	24	24	100
3,162	23	23	100
1,000	24	24	100
0,316	24	13	54
0,100	24	4	17
0,032	23	0	0
0,010	24	1	4

A sensibilidade analítica do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 foi determinada por análise Probit:

- Para a deteção de ARN específico do VSR A, a sensibilidade analítica é de 0,93 cópias/μl [intervalo de confiança (confidence interval, CI) de 95%: 0,61 - 1,95 cópias/μl]
- Para a deteção de ARN específico do VSR B, a sensibilidade analítica é de 0,83 cópias/μl [intervalo de confiança (confidence interval, CI) de 95%: 0,56 - 1,81 cópias/μl]

## 11.2 Especificidade Analítica

A especificidade analítica do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é garantida pela seleção meticulosa dos oligonucleotídeos (primers e sondas). Os oligonucleotídeos foram verificados pela análise de comparação das sequências com sequências publicamente disponíveis, para garantir que todos os genótipos relevantes do VRS A e VRS B serão detetados.

A especificidade analítica do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 foi avaliada através do teste a um painel de ARN/ADN genómico extraído de vírus relacionados com VSR e outros agentes patogénicos que provocam sintomas semelhantes a VSR.

O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 não reagiu com nenhum dos seguintes patogénicos:

- Adenovirus humano 1
- Adenovirus humano 2
- Adenovirus humano 3
- Adenovirus humano 4
- Virus parainfluenza 1
- Virus parainfluenza 2
- Virus parainfluenza 3
- Virus parainfluenza 4
- Metapneumovirus humano A
- Metapneumovirus humano B
- Virus da gripe A H1N1
- Virus da gripe B
- Virus Coxackie A3
- Rhinovirus
- Coronavirus 229E
- *Bordetella pertussis*
- *Bordetella parapertussis*
- *Chlamydomphila pneumoniae*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Haemophilus influenzae*
- *Legionella pneumophila*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Streptococcus pneumoniae*

### 11.3 Precisão

A precisão do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 foi determinada com base na variabilidade Intra-ensaio (variabilidade dentro de um ensaio), na variabilidade Inter-ensaio (variabilidade entre diferentes ensaios) e na variabilidade Inter-lote (variabilidade entre diferentes lotes de produção). A variabilidade total foi calculada através da combinação das três análises.

Os dados de variabilidade são expressos através do desvio padrão e do coeficiente de variação com base no ciclo limiar - valores ( $C_t$ ). Pelo menos seis réplicas por amostra foram analisadas quanto a variabilidade Intra-ensaio, variabilidade Inter-ensaio e variabilidade Inter-lote.

Tabela 3: Dados de precisão para a detecção de ARN específico do VSR A e do VSR B

VSR A e VSR B		Ciclo limiar médio ( $C_t$ )	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação [%]
Variabilidade Intra-ensaio	VSR A	32,14	0,06	0,20
	VSR B	33,24	0,08	0,30
Variabilidade Inter-ensaio	VSR A	32,24	0,13	0,40
	VSR B	33,18	0,10	0,30
Variabilidade Inter-lote	VSR A	31,70	0,45	1,42
	VSR B	33,26	0,12	0,36
Total Inter-lote	VSR A	31,91	0,49	1,54
	VSR B	33,21	0,13	0,39

Tabela 4: Dados de precisão para a detecção do Controlo Interno (Internal Control)

Controlo Interno (Internal Control)	Ciclo limiar médio ( $C_t$ )	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação [%]
Variabilidade Intra-ensaio	29,38	0,06	0,20
Variabilidade Inter-ensaio	29,23	0,16	0,55
Variabilidade Inter-lote	29,03	0,36	1,24
Variabilidade Total	29,05	0,30	1,03

### 12. Limitações

- A rigorosa conformidade com as instruções de utilização é necessária para resultados otimizados.
- A utilização deste produto está limitada a pessoal especialmente instruído e formado em técnicas de PCR em tempo real e em procedimentos de diagnósticos *in vitro*.
- A boa prática laboratorial é essencial para que este ensaio tenha um desempenho adequado. Deve-se ter um cuidado extremo para preservar a pureza dos componentes do kit e as configurações da reação. Todos os reagentes devem ser vigiados de perto para evitar impurezas e contaminação. Qualquer reagente duvidoso deve ser rejeitado.
- São necessários procedimentos de recolha, transporte, armazenamento e processamento adequados para o desempenho ideal deste teste.
- Este ensaio não pode ser utilizado diretamente no espécime. Devem ser realizados métodos apropriados de extração de ácido nucleico antes da utilização deste ensaio.
- A presença de inibidores RT-PCR (p.e. heparina) pode provocar falsos negativos ou resultados inválidos.
- A existência potencial de mutações nas regiões alvo do genoma do VSR A e VSR B abrangidas pelos primers e/ou sondas utilizados no kit poderá resultar na incapacidade de detecção da presença dos agentes patogénicos.
- Dependendo dos isolados do RSV e do instrumento de PCR em tempo real usado para a análise, poderá ocorrer uma ligeira reatividade cruzada entre o sistema VSR A e VSR B.
- Como em qualquer outro teste diagnóstico, os resultados do RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 têm de ser interpretados tendo em consideração todas as conclusões clínicas e laboratoriais.

### 13. Controlo de Qualidade

De acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade altona Diagnostics GmbH EN ISO 13485 certificado, cada lote de RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é testado face a especificações predeterminadas de modo a garantir uma qualidade do produto consistente.

### 14. Apoio Técnico

Para recomendações técnicas, contacte o nosso Apoio Técnico:

**E-mail:** support@altona-diagnostics.com

**Telefone:** +49-(0)40-5480676-0

### 15. Bibliografia

Versalovic, James, Carroll, Karen C., Funke, Guido, Jorgensen, James H., Landry, Marie Louise and David W. Warnock (ed). Manual of Clinical Microbiology. 10th Edition. ASM Press, 2011.

Cohen, Jonathan, Powderly, William G, and Steven M Opal. Infectious Diseases, Third Edition. Mosby, 2010.

### 16. Marcas Comerciais e Isenções de Responsabilidade

RealStar® (altona Diagnostics); ABI Prism® (Applied Biosystems); ATCC® (American Type Culture Collection); CFX96™ (Bio-Rad); Cy® (GE Healthcare); FAM™, JOE™, ROX™ (Life Technologies); LightCycler® (Roche); Maxwell® (Promega); Mx 3005P™ (Stratagene); NucliSENS®, easyMag® (bioMérieux); Rotor-Gene®, QIAamp®, QIASymphony® (QIAGEN); VERSANT® (Siemens Healthcare).

Os nomes registados, marcas comerciais, etc. utilizados neste documento, mesmo onde não estão especificamente marcados como tal, não devem ser considerados como estando desprotegidos pela legislação.
















O RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 é um kit de diagnóstico com a marcação CE de acordo com a Diretiva Europeia 98/79/EC relativa ao diagnóstico *in vitro*.

Produto não licenciado junto da Health Canada e não autorizado ou aprovado pela FDA.

Não disponível em todos os países.

© 2017 altona Diagnostics GmbH; todos os direitos reservados.

## 17. Explicação de Símbolos

	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Código do lote
	Cor cap
	Número do produto
	Índice
	Número
	Componente
	Número de identificação de comércio
	Consulte as instruções de utilização
	Contém o suficiente para "n" testes/reações (rxns)
	Limite de temperatura
	Data de validade
	Fabricante
	Atenção
	Nota
	Versão

## Notas:

**always a drop ahead.**

altona Diagnostics GmbH  
Mörkenstr. 12  
22767 Hamburg, Germany

phone +49 40 548 0676 0  
fax +49 40 548 0676 10  
e-mail [info@altona-diagnostics.com](mailto:info@altona-diagnostics.com)

[www.altona-diagnostics.com](http://www.altona-diagnostics.com)

